


手にとるように流れがつかめる！ 消化器内視鏡看護
検査・治療の開始前から終了・退院まで（第1版 第1刷と第2刷）
正誤表

このたびはご購入いただきまして誠に有難うございます。本書に誤りがございましたので、深くお詫び申し上げますとともに、下記のように訂正させていただきます。


p.100 図4

〔訂正箇所：プラスチックステントの名称。左がストレートタイプ、右がビッグテールタイプ。〕

(誤)

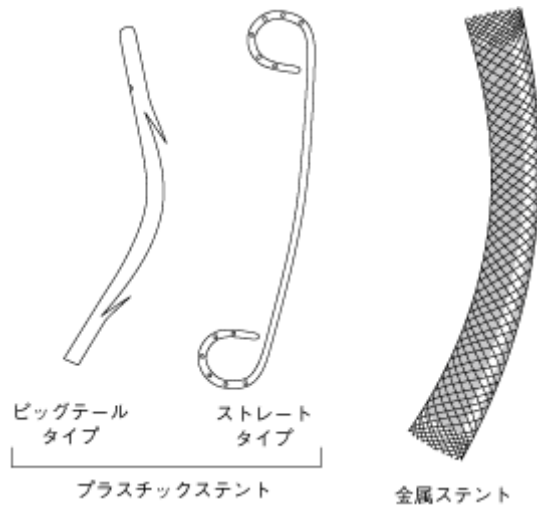

(正)

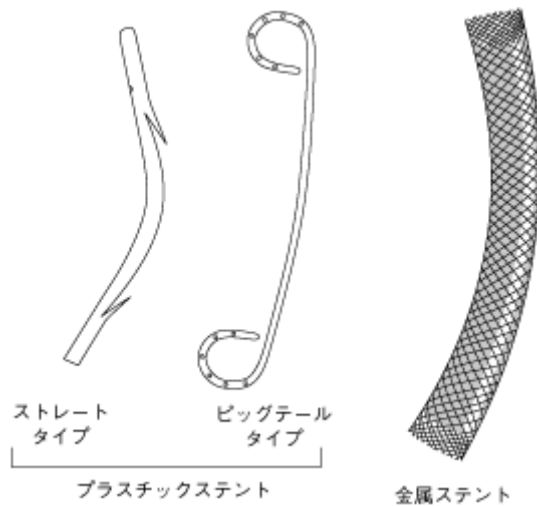

2011年11月現在